

CERTIFICATS D'ETALONNAGE RATTACHESCOFRAC

Le certificat d'étalonnage est un document certifiant la conformité et le bon fonctionnement d'un appareil de mesure. Il donne les résultats des mesures effectuées par rapport à un étalon et indique si l'exactitude des valeurs inscrites sur le manomètre est vérifiée.

Chaque certificat possède un numéro unique et n'est valable qu'une année à partir de sa date d'édition.

Ils peuvent être fournis pour les manomètres (de -1 à 1000 bar) de classes :

- 0.6 en Ø160
- 1 en Ø100 et 160
- 1.6 en Ø63

Et également pour tous les types de capteurs

Il existe trois types de certificats d'étalonnage :


- 5 points : 2 en montée, 3 en descente (CERTIF5M)
- 10 points : 5 en montée, 5 en descente (CERTIF)
- 20 points : 10 en montée, 10 en descente (CERTIFDI)

CERTIFICAT DE CONFORMITE

Le certificat de conformité (CERTIFCO) est un document attestant que les pièces commandées ont bien été fabriquées en conformité avec les normes standards autorisées. Seules les matières premières passées au contrôle qualité sont utilisées. Ce document ne comporte néanmoins aucun relevé de mesure.

Les certificats de conformité peuvent être établis pour tous types de produits : manomètres, thermomètres, siphons, robinets, manifolds, etc...

Les appareils décrits ci-dessus correspondent de par leur construction, dimensions et matériaux aux règles de l'art actuel. Nous nous réservons le droit de transformations et de changement de matériaux

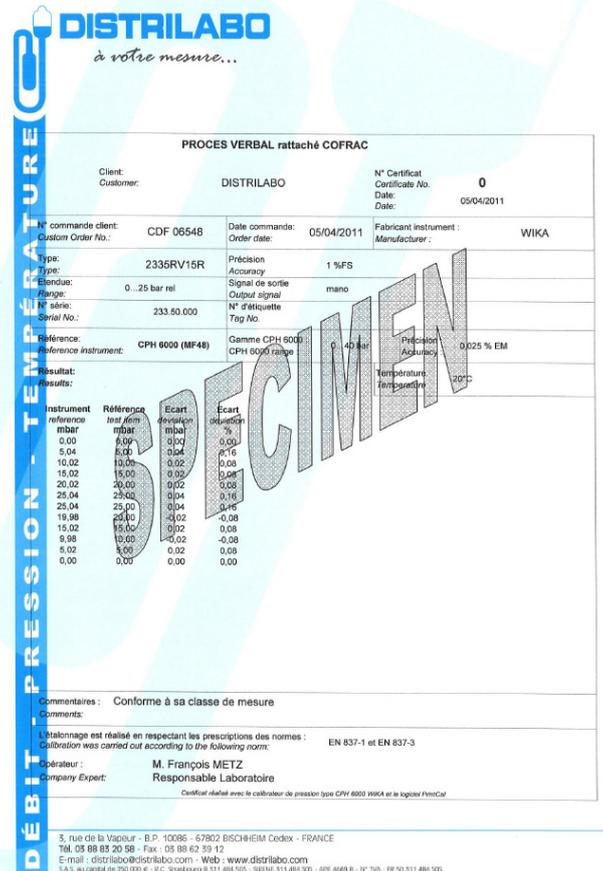

DISTRILABO
à votre mesure...

PROCES VERBAL rattaché COFRAC

Client / Customer:	DISTRILABO	N° Certificat / Certificate No:	0
		Date / Date:	05/04/2011
N° commande client / Custom Order No.:	CDF 06548	Date commande / Order date:	05/04/2011
		Fabricant instrument / Manufacturer:	WIKA
Type:	2335RV15R	Précision / Accuracy:	1 %FS
Echelle:	0 - 25 bar rei	Signal de sortie / Output signal:	mano
N° série / Serial No.:	233.50.000	N° d'étiquette / Tag No.:	
Référence / Reference instrument:	CPH 6000 (MF48)	Gamme CPH 6000 / CPH 6000 range:	0 - 40 bar
		Précision / Accuracy:	0,025 % EM
Results:		Température / Temperature:	20°C

Référence / Reference	Écart / Deviation	Écart / Deviation
mbar	mbar	%
0,00	0,00	0,00
5,04	0,00	0,00
10,02	0,00	0,00
15,02	0,00	0,00
20,02	0,00	0,00
25,04	0,00	0,00
25,04	0,00	0,00
19,98	0,00	0,00
15,02	0,00	0,00
9,98	0,00	0,00
5,02	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Commentaires : Conforme à sa classe de mesure

L'étalonnage est réalisé en respectant les prescriptions des normes : EN 837-1 et EN 837-3
 Calibration was carried out according to the following norm:

Opérateur : M. François METZ
 Responsable Laboratoire

3, rue de la Vapeur - B.P. 10086 - 67802 BISCHHEIM Cedex - FRANCE
 Tél. 03 88 83 20 58 - Fax : 03 88 62 33 12
 Email : distrilabo@distrilabo.com - Web : www.distrilabo.com
 S.A.S au capital de 250 000 € - RCS Strasbourg le 31/08/05 - SIREN 511 881 305 - APE 4690 B - N° TVA : FR 50 511 484 505